

附件 3 整改说明:

针对以上报告存在问题，我公司加强《程序文件》、《质量手册》、《职业卫生服务机构管理办法》等其他法律、法规的培训学习，提高自身技术水平，加强质量管理。



合肥市创思净化工程有限公司
Hebi Chuangsi Purification Engineering Co., Ltd.

合同编号: CJ2024-B0425001
签约地: 安徽

产品销售合同

甲方(采购方): 马鞍山安质环保科技有限公司
乙方(供货方): 合肥市创思净化工程有限公司

1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》, 在平等互利、协商一致的基础上, 甲方同意向乙方购买同时乙方同意授予甲方以下产品:


名称	规格	数量	单价	价格
FF 通风机	尺寸: 1800*900*2300 本体采用抗强酸碱化学药品, 耐冲蚀的 PP 板, 厚度 8-12mm, 排气内衬使用是 C 型耐强 PP 板, 厚度 8mm 电机: 液晶控制面板, LED 灯, 10A 多功能防凝结 内衬板: 5mm 厚度纯料 PFC 防腐板 等: 5mm 厚度纯料 PFC 防腐板 上下移动门: 5mm 钢化玻璃 结构: 拼装式+同步带轮	1 组	6500	6500
风管	风管连接材料有主风管, 数量待估	1 项	1000	1000
排风机	排风机排风风机 轴功率: 6.6 配置电机功率: 9.55kw 适用范围: 化验室 风叶直径: 0.4 风量: 4000-7000 排气材料: 活性炭箱	1 台	5500	5500
活性炭吸附箱		1 个	5000	5000
风阀	通风机管道风阀, 防止管道内串气制度	3 个	200	600
风道上接套		1 项	500	500
隔墙开孔		1 个	300	300
吊机使用费		1 项	1300	1300
FF 药品柜	FF 材料, 双人双锁	1 组	1200	1200

第 1 页 共 2 页

序号 10 有机前处理室整改情况
(预留空地)



序号 10 新增高温药品

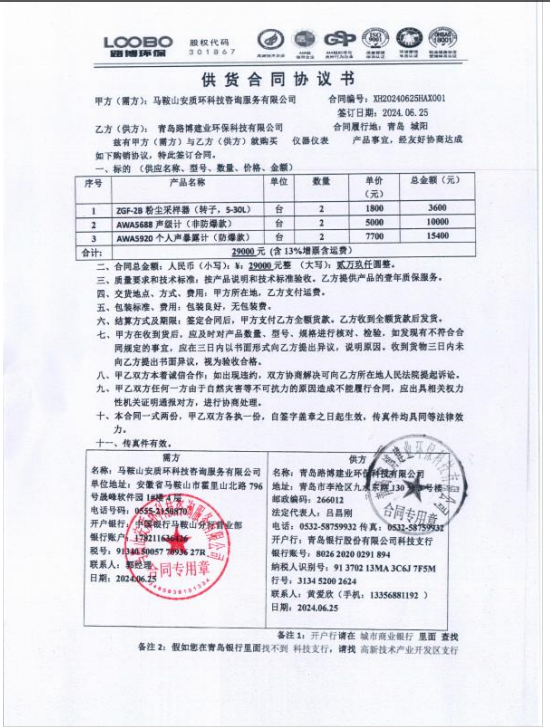

序号 11 整改情况(设备采购协议)



序号 10 整改情况（设备已到，正在安排计量中）

序号 15 整改情况（进一步完善管理评审资料）

马鞍山安质环科技咨询服务有限公司 专业技术人员培训记录表					
培训内容	职业卫生技术服务机构资质认定自查问题整改及整改		培训方式	授课、讨论	
培训目的	提升专业技术人员综合的提供专业化服务能力。				
培训时间	2024.6.22		培训地点	会议室	
责任部门	质量控制部	教师	潘东	培训教材	《职业卫生技术服务机构资质认定自查问题整改及整改》
参加人员	孙敏 蔡艳芳 刘少强 殷昭 张运新 殷昭 殷昭 李松 殷昭 霍晓东 李松 殷昭 王松 朱永林				
培训效果	良好				
备注	质量负责人：潘东 2024年6月23日				




马鞍山安质环科技咨询服务有限公司 专业技术人员培训记录表					
培训内容	职业卫生技术服务机构资质认定自查问题整改		培训方式	授课、讨论	
培训目的	掌握职业卫生技术服务机构资质认定自查问题整改及整改。				
培训时间	2024.6.23		培训地点	会议室	
责任部门	质量控制部	教师	蔡艳芳	培训教材	GBZ 231, GBZ 232
参加人员	李松 蔡艳芳 殷昭 张运新 刘少强 霍晓东 孙敏 李松 殷昭 王松 朱永林				
培训效果	良好				
备注	质量负责人：潘东 2024年6月24日				




整改过程--培训学习照片，培训签到等影像资料（序号：18、19、20、

21、22、26、27)

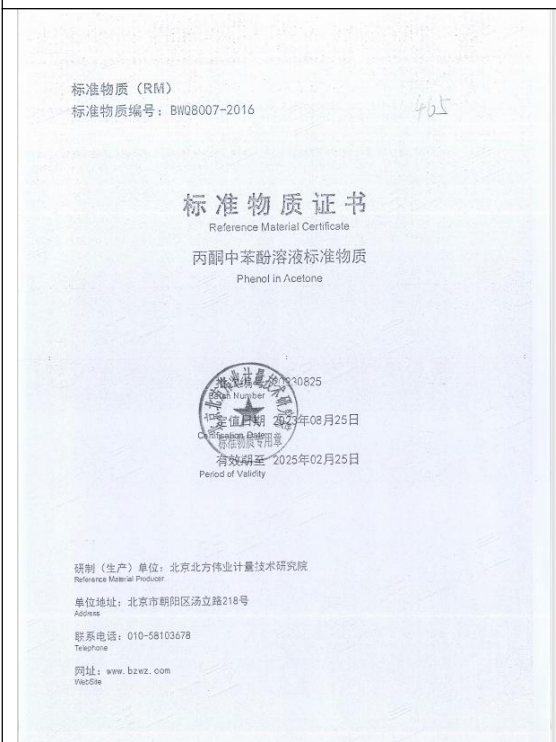

序号 24 整改情况（标准物质购买证书）

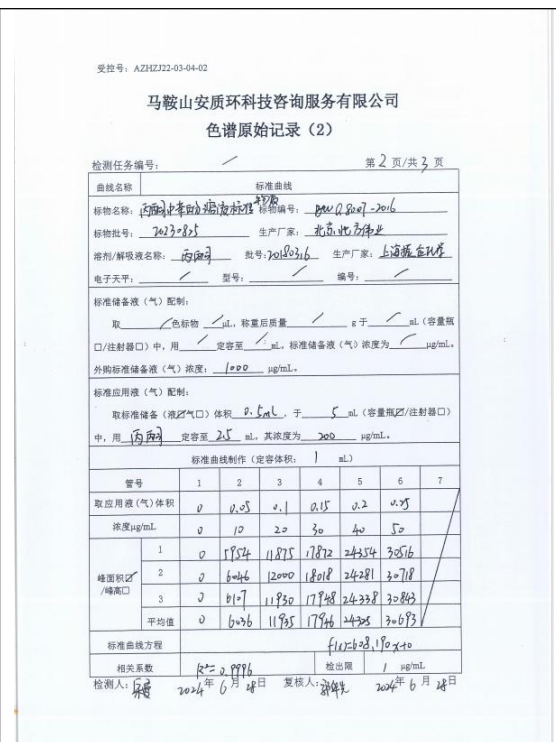

序号 91 序号 24 整改情况（标准曲线绘制）



序号 28 整改情况（完善报告及时归档）



序号 29 整改情况（已完成报告已及时报送国家信息平台）

